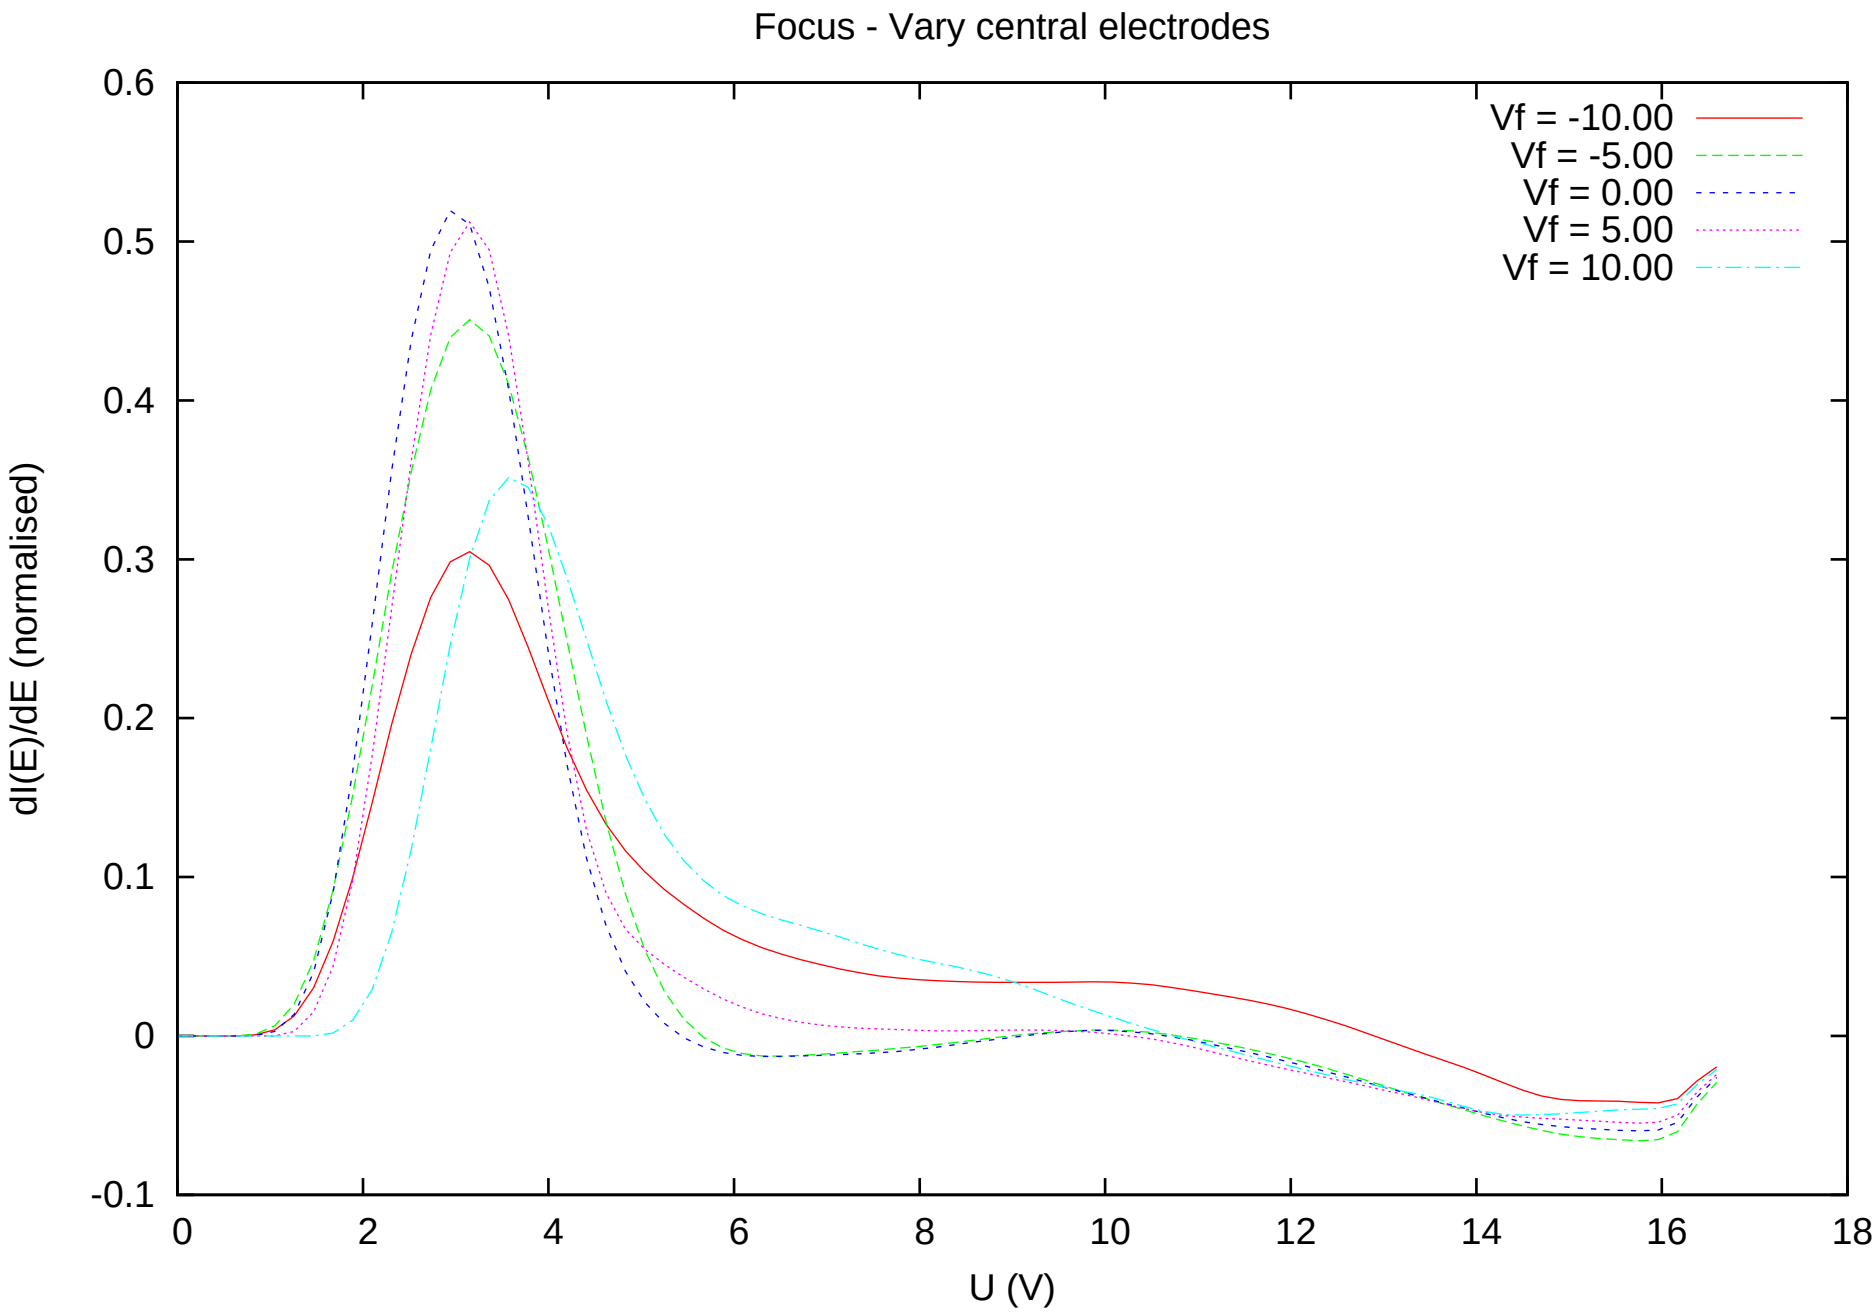
Focus - Vary central electrodes
Vf = -10.00
Vf = -5.00
Vf = 0.00
Vf = 5.00
Vf = 10.00
dI(E)/dE (normalised)
U (V)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18